Przepływomierz medyczny typu KOLIBRI

Autoryzowany dystrybutor

HYDRO-GAZ-MED sp.j.
ul. Popularna 8
05-200 Wołomin
tel. 22 787 65 60
fax. 22 776 01 51
www.gazmed.com.pl

Zastosowanie

Do dozowania tlenu, sprężonego powietrza i innych gazów gazów medycznych; w połączeniu z nawilżaczami lub dozownikami do podawania wilgotnego gazu. Akcesoria:

- nawilżacz
- dozownik
- końcówka na wąż 4/6 mm

Dane techniczne

Cechy:	skokowe ustawienie przepływu, wskaźnik poziomu przepływu, chromowany, metalowy, wtykany lub szynowy.
Wydajność:	regulowany skokowo przepływ w przedziałach:
	Neonatal: 0-0,5 l/min
	Children: 0-4 l/min
	Standard: 0-15 l/min
	Standard+: 0-30 l/min
	ciśnienie wejściowe: 450 kPa ± 50 kPa
	dokładność pomiaru: ± 10% mierzonej wartości
Podłączenie:	gazo-szczególny wtyk zgodny z DIN 13260-2 lub AGA
	opcjonalne standardy: NF, BS, Medap-C

Informacje dodatkowe

- Zawsze należy utrzymywać koncówki wolne od smarów i tłuszczy !
- Przepływomierz spełnia podstawowe wymagania dyrektywy MDD 93/42/EEC; Klasa IIa.
- Zgodny z DIN EN 13220
- Zmiany w urządzeniu: inne wzory na zamówienie.

CE 0482

Przepływomierz medyczny typu KOLIBRI

Działanie

Przed umieszczeniem w punkcie poboru, ustawić przepływ na "0". Przykręcić do szyny. Model wtykany umieścić bezpośrednio w punkcie; model szynowy - umieścić wtyk kątowy w punkcie poboru.

Akcesoria przykręcać zawsze ręcznie: przed pierwszym użyciem, wysterylizować butelkę; zamocować wężyk i dozownik od butelki pod przepływomierzem; napełnić butelkę wodą destylowaną i przykręcić; podłączyć akcesoria dodatkowe.

Ustawić przepływ regulatorem. W trakcie używania zwracać uwagę na poziom wody w butelce. Nie może spaść poniżej dolnej kreski.

Po skończonym używaniu ustawić regulator przepływu na "0". Przepływomierz może pozostać w punkcie poboru. Jesli to konieczne odkręcić butelkę od przepływomierza, opłukać i wysterylizować.

Konserwacja i naprawy

Zewnętrzna dezynfekcja szmatką jest wystarczająca dla wszystkich części chromowanych. Butelkę nalezy sterylizować w temperaturze 134°C. Przed ponownym użyciem urządzenie musi dokładnie wyschnąć.
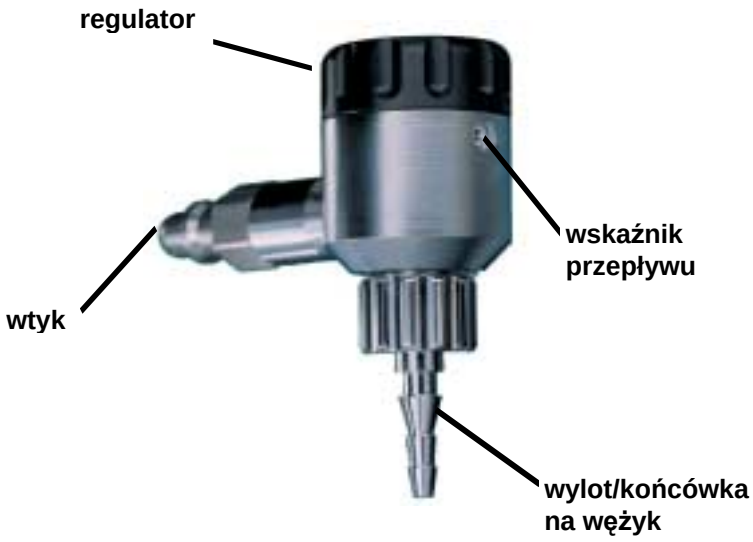
Przed każdym użyciem należy wykonać kontrolę wizualną (uszkodzenia). Urządzenie powinno być konserwowane przynajmniej raz na 5 lat (działanie i szczelność). Uszkodzenia mogą być usuwane tylko przez wyszkolony personel. Używać tylko oryginalnych części firmy GREGGERSEN!